

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 97688-26

Срок действия утверждения типа до **12 февраля 2031 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Системы виброметрические балансировочные ВИБРОЛАБ-5**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**Общество с ограниченной ответственностью «Энсет»  
(ООО «Энсет»), г. Ростов-на-Дону**

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ  
**Общество с ограниченной ответственностью «Энсет»  
(ООО «Энсет»), г. Ростов-на-Дону**

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
**ОС**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**МП 325-2025**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **3 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии **от 12 февраля 2026 г. N 244.**

Заместитель Руководителя

Е.Р.Лазаренко

Подлинник электронного документа, подписанный ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

«16» февраля 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «12» февраля 2026 г. № 244

Регистрационный № 97688-26

Лист № 1  
Всего листов 5

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Системы виброизмерительные балансировочные ВИБРОЛАБ-5

#### **Назначение средства измерений**

Системы виброизмерительные балансировочные ВИБРОЛАБ-5 (далее – системы) предназначены для измерений параметров вибрации (виброперемещения), частоты вращения, мониторинга и контроля параметров вибрации (виброперемещения) опор балансировочных станков.

#### **Описание средства измерений**

Принцип действия систем основан на измерении и обработке электрических сигналов, поступающих от первичных преобразователей.

В качестве первичных преобразователей в каналах измерения виброперемещения могут использоваться пьезоэлектрические или емкостные акселерометры (первичные преобразователи не входят в состав системы).

Системы позволяют осуществлять регистрацию и математический анализ полученных значений параметров вибрации.

Система позволяет программировать действительное значение коэффициентов преобразования первичных преобразователей виброперемещения. Дополнительно системы имеют функцию измерения частоты вращения ротора на основании обработки сигналов первичных преобразователей. В качестве первичных преобразователей в каналах измерения частоты вращения могут использоваться отметчики оборотов лазерные или индуктивные.

Конструктивно системы выполнены в виде единого корпуса, в котором размещены измерительная плата, блок питания, промышленный компьютер, а также установлены разъемы для подключения внешних устройств.

Системы выпускаются в двух модификациях:

- ВИБРОЛАБ-5.М – сенсорный дисплей расположен на передней части корпуса;
- ВИБРОЛАБ-5.К – сенсорный дисплей подключается по интерфейсам HDMI и USB.

Заводской номер в виде латинских букв и арабских цифр наносится методом лазерной гравировки на маркировочную табличку (рисунок 4), расположенную на корпусе, и типографским способом в паспорт. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Для исключения несанкционированного доступа корпус системы пломбируется легко разрушаемыми наклейками в 2 местах (в соответствии с рисунком 1).

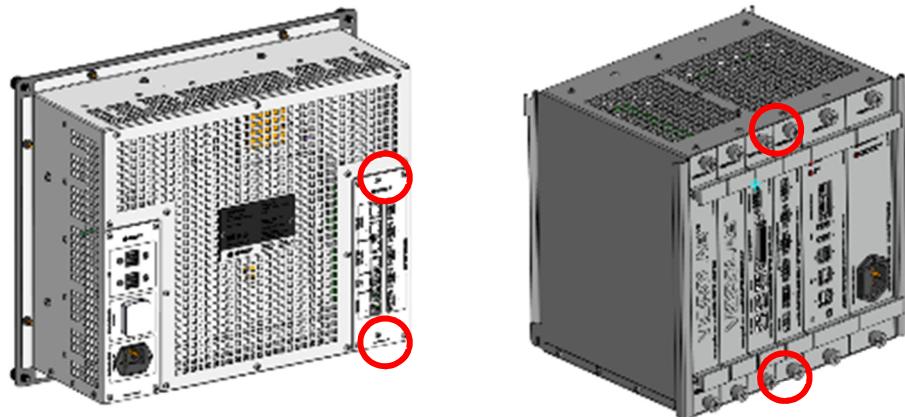


Рисунок 1 – Места пломбирования системы от несанкционированного доступа

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Общий вид системы ВИБРОЛАБ-5.М представлен на рисунке 2, ВИБРОЛАБ-5.К на рисунке 3, маркировочной таблички на рисунке 4.

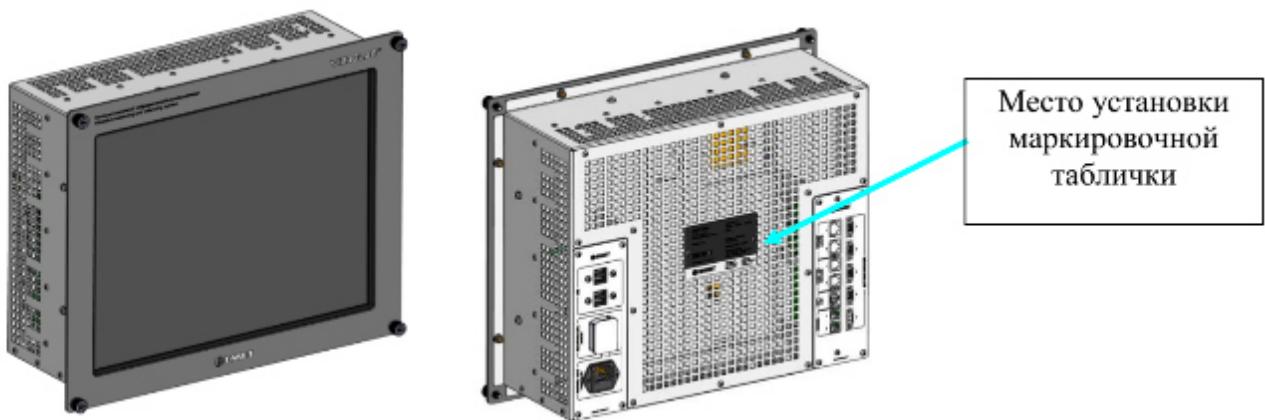


Рисунок 2 – Внешний вид системы ВИБРОЛАБ-5.М

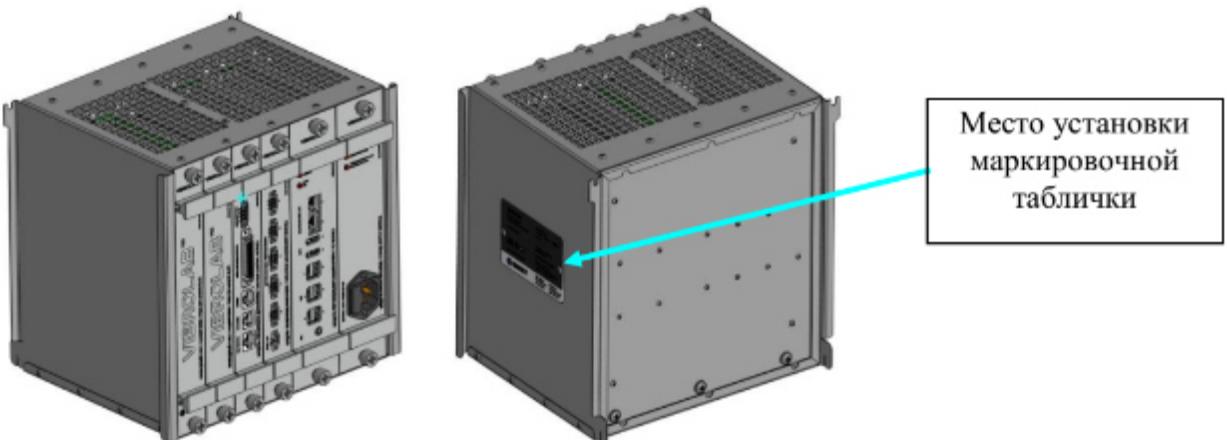


Рисунок 3 – Внешний вид системы ВИБРОЛАБ-5.К

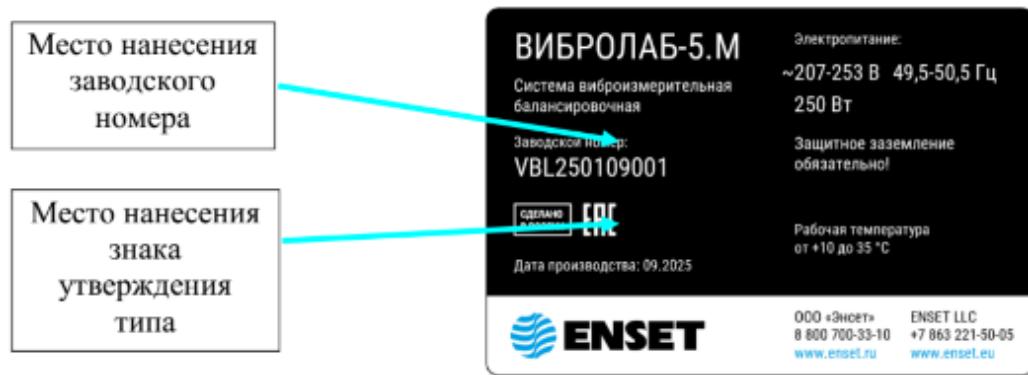


Рисунок 4 – Маркировочная табличка, место нанесения заводского номера и знака утверждения типа

### Программное обеспечение

Метрологически значимая часть программного обеспечения (ПО) находится в микропроцессоре, прошивка которого осуществляется при изготовлении системы.

Конструкция системы исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию, так как ПО прошито в микропроцессоре, жестко установленном внутри печатной платы.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Наименование параметра	Значение
Идентификационное наименование ПО	VIBROLAB
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	5.x*

\* - «x» принимает значения от 0 до 9 и не относится к метрологически значимой части ПО.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество каналов измерения виброперемещения, шт.	от 1 до 5**
Диапазон входного напряжения переменного тока (амплитудное значение), мВ	от 5 до 5000
Диапазон рабочих частот, Гц	от 1,5 до 500
Диапазон измерений размаха виброперемещения на базовой частоте 40,9 Гц при коэффициенте преобразования $K=75,6 \text{ мВ}/(\text{мс}^{-2})$ , мкм	от 1 до 1000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений размаха виброперемещения на базовой частоте 40,9 Гц, %	±3
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) относительно базовой частоты 40,9 Гц, в диапазоне рабочих частот, %	±3
Количество каналов измерения частоты вращения, шт.	от 1 до 2**
Диапазон измерения частоты вращения, об/мин	от 90 до 30 000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты вращения, об/мин	±(1+0,0025·n) где n – значение частоты

\*\* – количество измерительных каналов определяется при заказе

Таблица 3 – Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
	ВИБРОЛАБ-5.М	ВИБРОЛАБ-5.К
Потребляемая мощность, В·А, не более	250	
Параметры электрического питания от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	от 207 до 253 от 49,5 до 50,5	
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха, %	от +10 до +35 от 30 до 80	
Габаритные размеры, мм, не более - высота - ширина - длина	350 155 415	260 220 265
Масса, кг, не более	25	15

#### Знак утверждения типа

наносится фотохимическим методом на маркировочную табличку, размещаемую на корпусе системы и на титульный лист паспорта типографским методом.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Система виброизмерительная балансировочная ВИБРОЛАБ-5		1 шт.
Руководство по эксплуатации		1 экз.
Паспорт		1 экз.

#### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1.4 «Устройство и принцип действия, применяемые методы измерений» руководства по эксплуатации.

#### Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 27 декабря 2018 г. № 2772 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения»;

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2360 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;

ТУ 26.51.45-003-38447005-2025 «Системы виброизмерительные балансировочные ВИБРОЛАБ-5. Технические условия».

#### Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Энсет»

(ООО «Энсет»)

ИНН 6165177184

Юридический адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

Тел. +7 800 700-33-10, +7 863 221-50-05


E-mail: info@enset.ru

### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Энсет»  
(ООО «Энсет»)  
ИНН 6165177184  
Адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1  
Тел. +7 800 700-33-10, +7 863 221-50-05  
E-mail: info@enset.ru

### Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области»  
(ФБУ «Ростовский ЦСМ»)  
Адрес: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173  
Телефон: (863) 290-44-88, факс: (863) 291-08-02  
E-mail: info@rostcsm.ru  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 30042-13

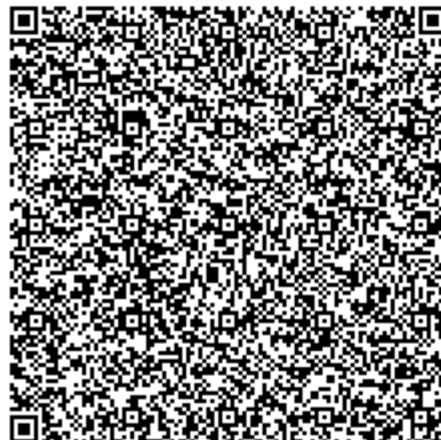

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

М.п

«16» февраля 2026 г.